

## Технические данные

### Пипетки серологические 50 мл, для ПЦР


#### 1. Назначение

Серологические пипетки предназначены для точного дозирования и пипетирования различных жидкостей.

#### 2. Материалы

Пипетка – полистирол общего назначения, в соответствии с USP Класс VI. Цвет – бесцветный, прозрачный.

#### 3. Характеристики

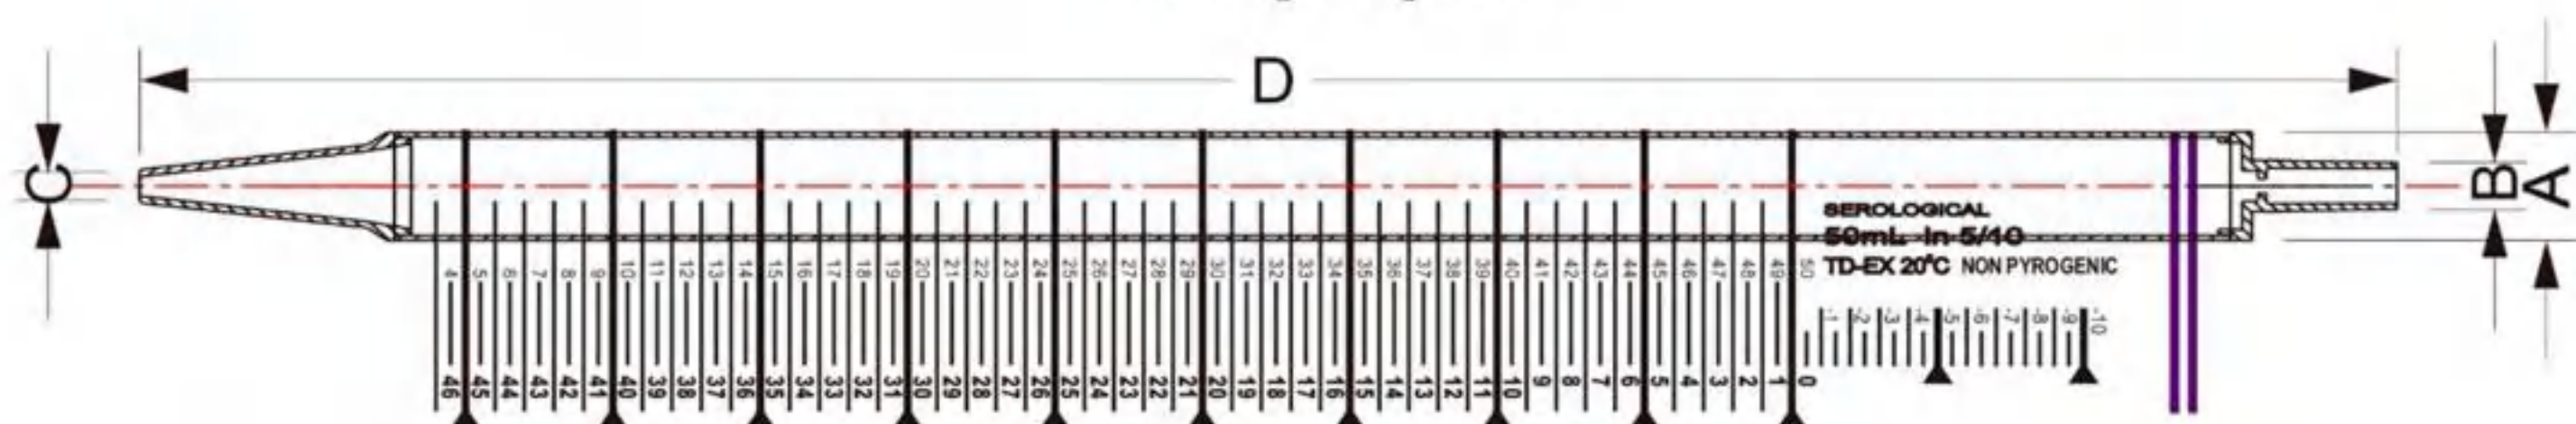

	Размеры	Погрешность
A	Ø 18,4 мм	± 0,1 мм
B	Ø 8,0 мм	± 0,1 мм
C	Ø 5,8 мм	± 0,1 мм
D	346,6	± 2,0 мм

- Температурный режим: от -20°C до +50°C.
- Стерилизовано гамма-излучением SAL10<sup>-6</sup> (ISO11137).
- Данное изделие не содержит латекс.
- Не содержит ДНКазы, РНКазы и пирогены. Не цитотоксично, не вызывает гемолиз.
- Соответствует требованиям ТГЭ/ГЭКРС.
- Автоклавирование – нет.
- Отрицательная градуировка до -10,0 мл (общий объем – 60,0 мл).
- Градуировка (мл): 5/10.
- Градуировка откалибрована для точности дозирования с точностью до ± 2%.
- Цветовой код: фиолетовый.
- Срок годности: 3 года.
- Изготовлены в чистом помещении класса 100 000.
- Произведены в соответствии с ISO13485:2003 и ISO9001:2008 системой управления качеством.

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Артикул	Код производителя	Описание	Стерильность	Упаковка, шт
11000945	GSP-010-050	50 мл, 5/10 мл, цвет фиолетовый, инд. уп.	Да	Индив. упак./ 100