

Технические данные

Пипетки серологические 2 мл, для ПЦР


1. Назначение

Серологические пипетки предназначены для точного дозирования и пипетирования различных жидкостей.

2. Материалы

Пипетка – полистирол общего назначения, в соответствии с USP Класс VI. Цвет – бесцветный, прозрачный.

3. Характеристики

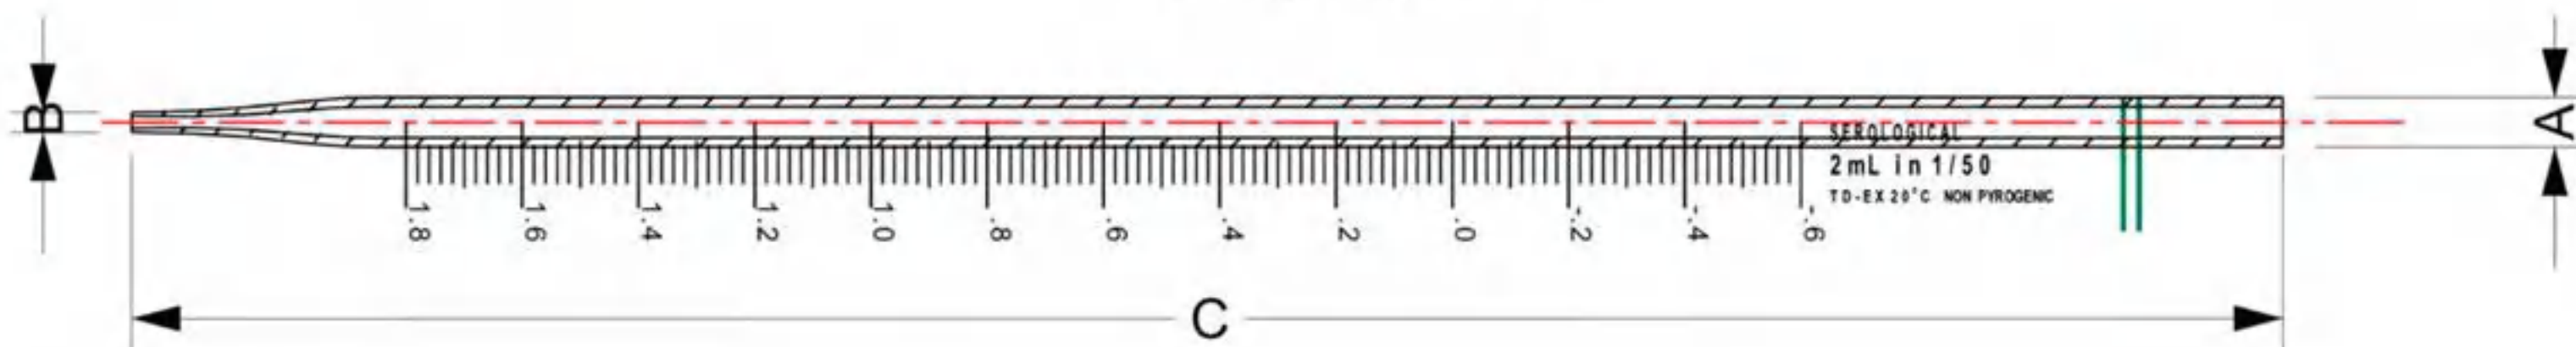

	Размеры	Погрешность
A	Ø 6,3 мм	± 0,1 мм
B	Ø 2,93 мм	± 0,35 мм
C	272,0 мм	± 2,0 мм

- Температурный режим: от -20°C до +50°C.
- Стерилизовано гамма-излучением SAL10⁻⁶ (ISO11137).
- Данное изделие не содержит латекс.
- Не содержит ДНКазы, РНКазы и пирогены. Не цитотоксично, не вызывает гемолиз.
- Соответствует требованиям ТГЭ/ГЭКРС.
- Автоклавирование – нет.
- Отрицательная градуировка до -0,6 мл (общий объем – 2,6 мл).
- Градуировка (мл): 1/50.
- Градуировка откалибрована для точности дозирования с точностью до ± 2%.
- Цветовой код: зеленый.
- Срок годности: 3 года.
- Изготовлены в чистом помещении класса 100 000.
- Произведены в соответствии с ISO13485:2003 и ISO9001:2008 системой управления качеством.

ООО «МИНИМЕД»
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Артикул	Код производителя	Описание	Стерильность	Упаковка, шт
11000941	GSP-010-002	2 мл, 1/50 мл, цвет зеленый, инд. уп.	Да	Индив. упак./ 500