

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1851/1218GK

Полоски индикаторные
для определения глюкозы и кетонов в моче

БИОСКАН - ГЛЮКОЗА, КЕТОНЫ


Серия № 1851GK изготовлена в декабре 2018 г. в количестве 1 000 наборов (100 полосок в одном наборе), срок годности - два года, до 31 декабря 2020 г.

Результаты контроля на соответствие ТУ 9398-010-33020495-2006:

Индикаторный элемент для определения глюкозы:		
чувствительность сенсорного элемента	развитие светло-зеленой окраски при использовании контрольного раствора глюкозы с концентрацией 0,05 %.	п.п. 4.2.3.1 ТУ
время выхода сенсорного элемента на соответствующую окраску, сек., не более	120 сек. при использовании контрольного раствора глюкозы с концентрацией 1,0 %.	п.п. 4.2.3.2 ТУ
показатели правильности определения	развитие окраски, совпадающей с соответствующими полями цветовой шкалы, при использовании контрольных растворов глюкозы с концентрациями 0,05, 0,1, 0,3, и 1,0 %;	п. 4.2.3.3 ТУ
Индикаторный элемент для определения кетонов:		
чувствительность сенсорного элемента	развитие светло-розовой окраски при использовании контрольного раствора ацетоуксусной кислоты с концентрацией 0,5 ммоль/л.	п.п. 4.2.3.1 ТУ
время выхода сенсорного элемента на соответствующую окраску, сек., не более	120 сек. при использовании контрольного раствора ацетоуксусной кислоты с концентрацией 10 ммоль/л.	п.п. 4.2.3.2 ТУ
показатели правильности определения	развитие окраски, совпадающей с соответствующими полями цветовой шкалы, при использовании контрольных растворов ацетоуксусной кислоты с концентрациями 0,5, 1, 4 и 10 ммоль/л.	п. 4.2.3.3 ТУ

Полоски индикаторные для определения глюкозы и кетонов в моче БИОСКАН-ГЛЮКОЗА, КЕТОНЫ серии № 1851GK соответствуют ТУ 9398-010-33020495-2006.

Начальник ОТК
ООО «БИОСКАН»

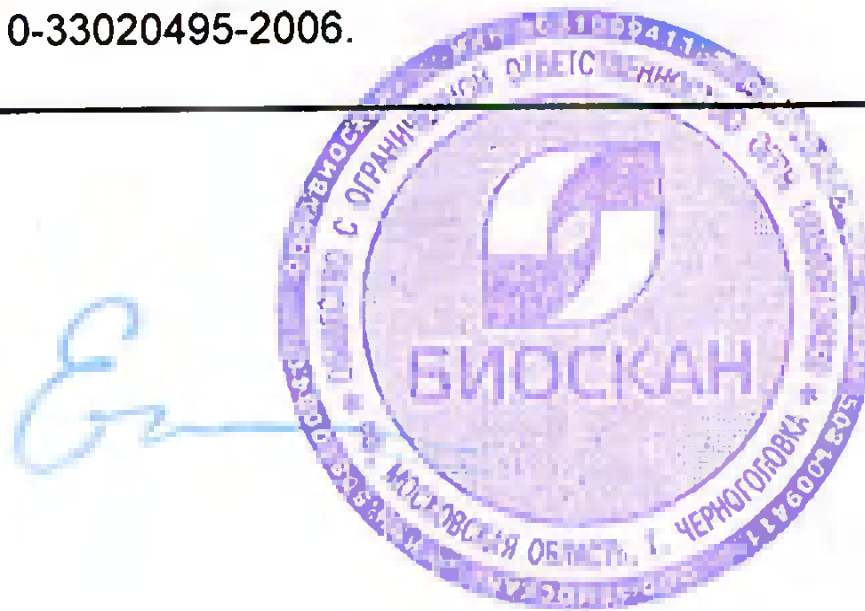

/Ечмаева Т.А./