

Технические данные

Пипетки серологические 10 мл, для ПЦР


1. Назначение

Серологические пипетки предназначены для точного дозирования и пипетирования различных жидкостей.

2. Материалы

Пипетка – полистирол общего назначения, в соответствии с USP Класс VI. Цвет – бесцветный, прозрачный.

3. Характеристики

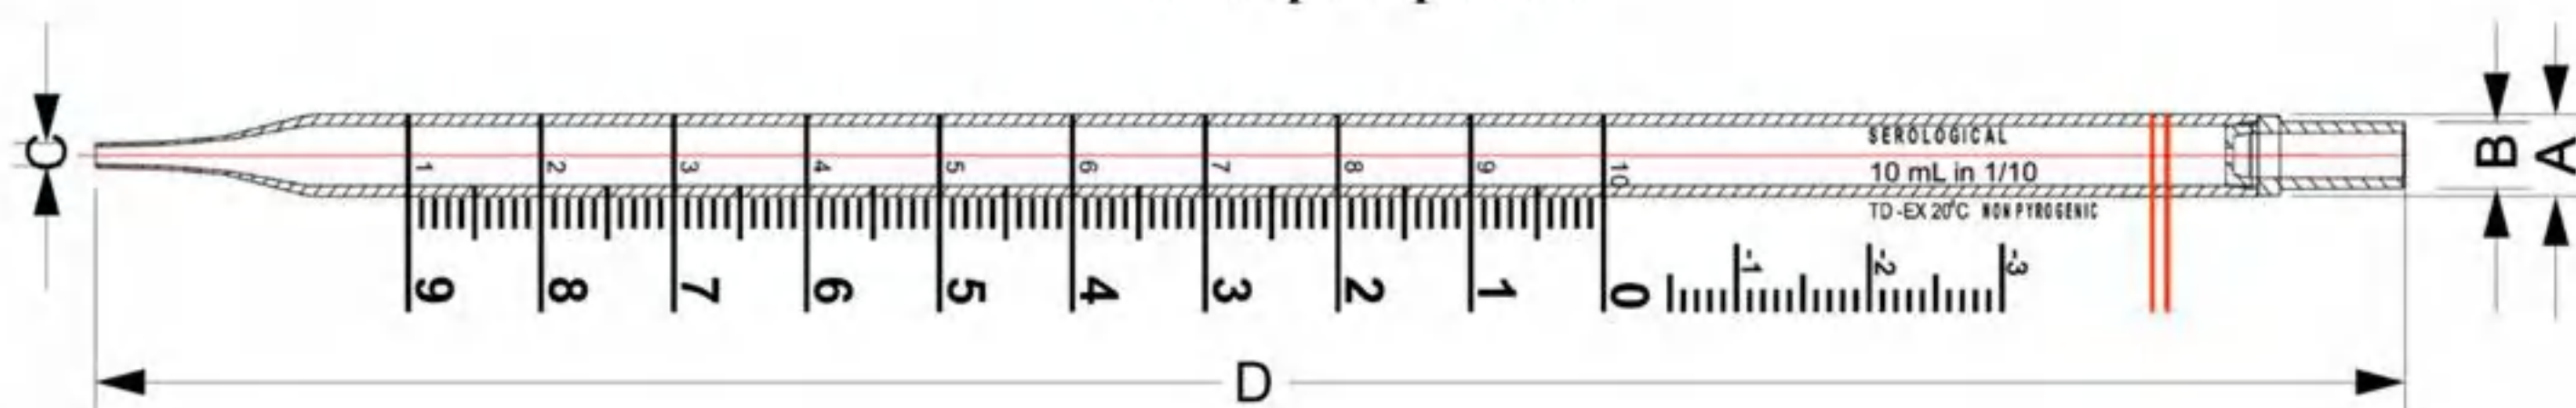

	Размеры	Погрешность
A	Ø 10,96 мм	± 0,2 мм
B	Ø 7,95 мм	± 0,2 мм
C	Ø 2,95 мм	± 0,25 мм
D	303,4	± 2,0 мм

- Температурный режим: от -20°C до +50°C.
- Стерилизовано гамма-излучением SAL10⁻⁶ (ISO11137).
- Данное изделие не содержит латекс.
- Не содержит ДНКазы, РНКазы и пирогены. Не цитотоксично, не вызывает гемолиз.
- Соответствует требованиям ТГЭ/ГЭКРС.
- Автоклавирование – нет.
- Отрицательная градуировка до -3,0 мл (общий объем – 13,0 мл).
- Градуировка (мл): 1/10.
- Градуировка откалибрована для точности дозирования с точностью до ± 2%.
- Цветовой код: оранжевый.
- Срок годности: 3 года.
- Изготовлены в чистом помещении класса 100 000.
- Произведены в соответствии с ISO13485:2003 и ISO9001:2008 системой управления качеством.

ООО «МИНИМЕД»
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Артикул	Код производителя	Описание	Стерильность	Упаковка, шт
11000943	GSP-010-010	10 мл, 1/10 мл, цвет оранжевый, инд. уп.	Да	Индив. упак./ 200